EMO especialistas en ortopedia 150002

Ortesis tipo AFO

CentralFab by EMO

Paciente		Pedido	O.Fabricación
Cliente			
Técnico			

Entrada de datos

Molde Escayola (1) ◯ Molde Fibra (2) ◯ Fichero escaneado (4) ◯

Rectificación / Trabajo sobre el molde

Corregir: Flex-Ext_____(90º) Varo-Valgo_____(neutro) Otros especificar_____

Molde Negativo ya Rectificado ◯ Molde Positivo ya Rectificado ◯

Estándar (2001) ◯ Especificar corrección necesaria_____

Modelos

INTERIOR (23): Forro EVA-Flexible (1)◯ Forro PLASTAZOTE (2)◯ Almohadilla TEXTIL (0)◯

Completo ◯ Solo planta ◯

EXTERIOR (20): Polipropileno 3mm ◯ 4mm ◯

Polietileno HD 3mm ◯ 4mm ◯

Polietileno LD 3mm ◯ 4mm ◯

Fibra Carbono ◯

ESPECIAL, otro material_____

_____

DECORACION TRANSFER (2200): ◯ Modelo_____

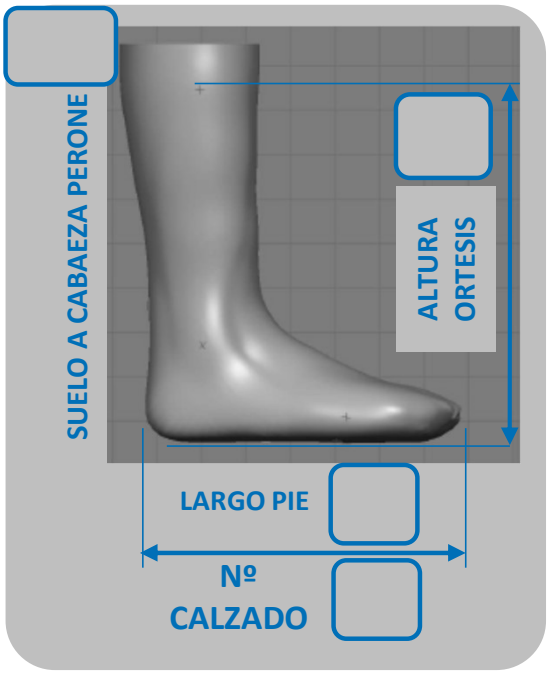

CINTAS (2100): Marcar si se requiere y tipo en cada caso

Pantorrilla ◯___ Empeine ◯___ Antepie ◯___

1. Cinta envolvente con hebilla (0)
2. Cinta y hebilla remachadas (1)
3. Tira con sujeción de velcro adhesivo (2)

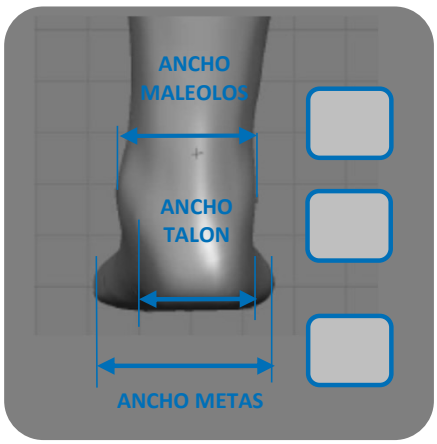

LADO: IZQ. ◯ DCH. ◯

Para la obtención del molde o escaneado, colocar al paciente corrigiendo al máximo la posición de tobillo y talon, y con la planta apoyando en el suelo. Enviar fotos frontal, lateral derecha e izquierda, posterior.